



ZionCare

穿戴裝置與應用程式使用手冊

## 關於 ZionCare

ZionCare 是一個收集醫療級數據以進行睡眠健康監測的平台，由先豐科技股份有限公司（MtM+ Technology）所開發，其整體項目包含穿戴裝置、應用程式與後台系統三個部份，此外，ZionCare 監測睡眠數據推出的穿戴裝置—oCare Pro 100（以下簡稱穿戴裝置）是世界上第一款無需傳統指尖探頭即可工作的可穿戴式脈搏血氧裝置，讓患者在舒適的狀態下進行準確檢測，甚至不需親自就診，僅需授權給醫護人員，使其透過後台獲取數據進而予以治療即可，本設備由台醫光電所研發，是首個也是唯一一個通過 FDA（台灣、美國和澳洲）和 CE 標誌認證的脈搏血氧儀，並符合該區域必要認證的可穿戴式硬體設備，患者在睡眠數據記錄之後，可藉由應用程式進行數據上傳來追蹤睡眠狀況並取得相關分析。

## 適用裝置

ZionCare 穿戴裝置需搭配應用程式進行數據上傳與報告獲取，應用程式可安裝在 Andriod 及 iOS 系統的手機上，並支援 iOS **X.X** 以上的系統。

- Android
  - Huawei Y9
  - Samsung A51
  
- iPhone
  - iPhone 11 (iOS15.4.1)

## 協助

若在操作中遇到問題可透過以下方式聯絡本公司客服單位進行協助。

信箱：[support@mtmtech.com.tw](mailto:support@mtmtech.com.tw)

電話：[+886-2-7736-7386](tel:+886-2-7736-7386)


# 手冊目錄

穿戴裝置與應用程式使用手冊.....	1
關於 ZionCare .....	2
適用裝置.....	2
協助.....	2
如何使用穿戴裝置？.....	4
裝置穿戴.....	5
裝置操作.....	6
如何安裝 ZionCare 應用程式？ .....	7
安裝應用程式.....	8
開啟藍芽傳輸權限.....	9
建立帳號.....	10
填寫帳號資訊.....	11
登入帳號.....	12
穿戴裝置與應用程式如何連接？ .....	13
裝置配對.....	14
裝置連接.....	15
如何記錄睡眠數據？ .....	16
記錄數據.....	17
同步數據.....	18
開始同步.....	19
睡眠報告.....	20
詳細數據.....	21
睡眠趨勢.....	22
設定量測.....	23
記錄量測.....	24
填寫問卷.....	25
故障排除.....	26
應用程式無法連接穿戴裝置.....	27
同步數據等待時間過長.....	28
同步後卻沒有數據.....	28
登入後顯示沒有網路.....	28


## 如何使用穿戴裝置？

## 裝置穿戴


將錶帶調整至適當位置。

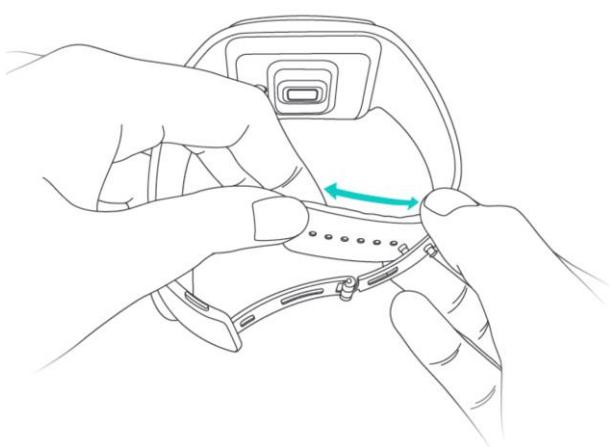


穿戴裝置邊緣請勿超出或覆蓋尺骨莖突處。

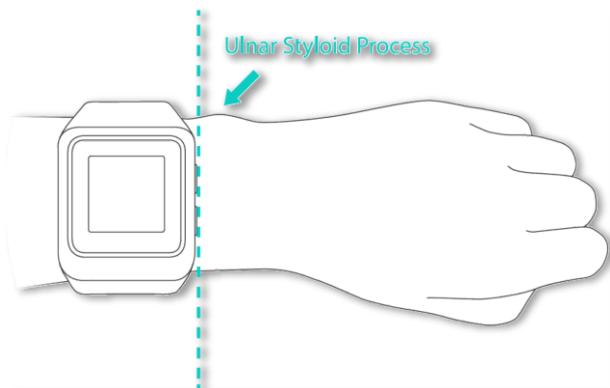

扣上錶扣，請注意，完成佩帶後，穿戴裝置背面需和手腕皮膚貼合，手腕晃動時，穿戴裝置不會前後移動為正確的佩帶方式。

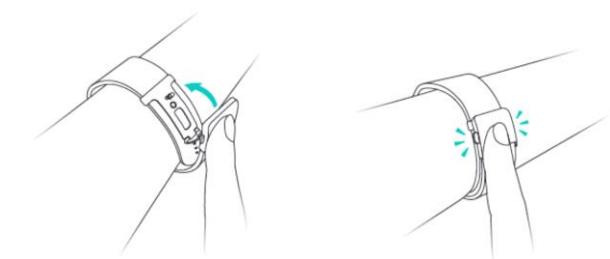

按壓錶扣二側簧片將並拉起扣合處，即可取下穿戴裝置。

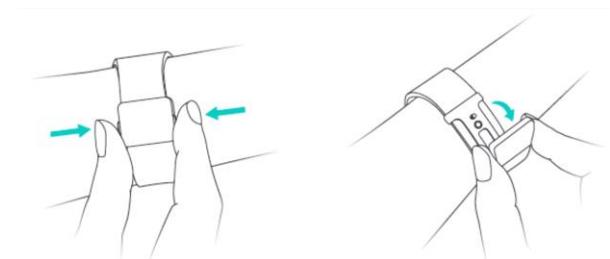

## 裝置操作

長按穿戴裝置右側下方按鈕即可開機，  
請注意電量是否充足。

開機後，穿戴裝置右側下方按鈕可切換  
至選單及選擇選單項目。

開機後，穿戴裝置右側上方按鈕可進行  
時間與檢測模式的畫面切換，也可於選  
單中切換選項。




## 如何安裝 ZionCare 應用程式？

## 安裝應用程式

Apple 使用者：

至 App Store 搜尋 **ZionCare App** 即可下載及安裝。

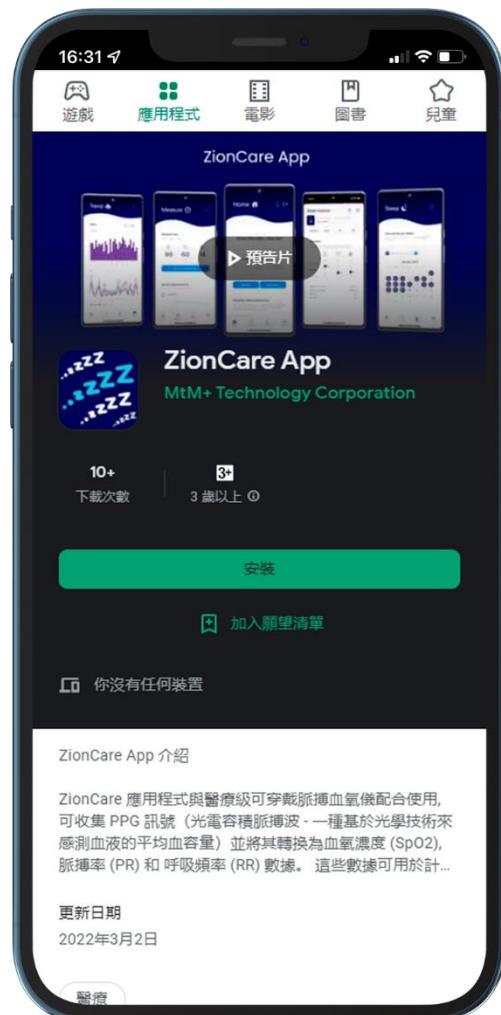

Android 使用者：

至 Google Play 搜尋 **ZionCare App** 即可下載及安裝。

## 開啟藍芽傳輸權限

安裝完成後，ZionCare 應用程式需要開啟藍芽傳輸權限方可將穿戴裝置數據上傳至應用程式。



## 建立帳號

如果您沒有帳號，可在進入應用程式後點選**建立帳號**來註冊。



## 填寫帳號資訊

註冊帳號時需要填寫性別與生日等基本  
數據。



## 登入帳號

如果您已經註冊好帳號了，可回到登入  
畫面進行登入。



## 穿戴裝置與應用程式如何連接？

## 裝置配對

將穿戴裝置與應用程式開機，並確認藍芽功能已開啟，即可自動透過藍芽來連接裝置，第一次配對需要輸入 6 位數驗證碼，此時驗證碼會顯示於穿戴裝置的螢幕上，輸入並點選配對即可。



### 幫助：

- 如何使用穿戴裝置？
- 穿戴裝置無法連線。

## 裝置連接

若連接成功，可在穿戴裝置左上方看到藍芽符號變成雙箭頭符號，在應用程式右上方的穿戴裝置圖示也會切換成藍色，若只有顯示藍芽符號表示穿戴裝置已經開啟藍芽功能，但未與應用程式連線，此時只需開啟應用程式並保持連線即可。



### 幫助：

- 如何使用穿戴裝置？
- 穿戴裝置無法連線。

## 如何記錄睡眠及取得報告？

## 記錄數據

你可以透過穿戴裝置的選單來開始記錄數據，也可以透過應用程式首頁的開始記錄按鈕來啟用，若您透過應用程式啟用，請確保穿戴裝置為連接狀態。



### 幫助：

- 如何使用穿戴裝置？
- 穿戴裝置無法連線。

## 同步數據

數據蒐集完畢後，可以至應用程式首頁中點選**同步數據**按鈕進行上傳，與此同時，穿戴裝置會顯示上傳中的圖示，請勿在此時中斷操作，操作過程中也請保持連接狀態。



### 幫助：

- 如何使用穿戴裝置？
- 同步數據等待時間過長。

## 開始同步

點選畫面中的開始按鈕。



靜置 5-10 分鐘上傳數據。



完成後會呈現此畫面。



## 睡眠報告

上傳完成後，可以到**睡眠點選深色圓形的按鈕**來查閱當日的睡眠報告。



## 詳細數據

透過上方資料切換，除了總覽資訊外，也可以根據血氧濃度、脈搏與呼吸頻率分別進行瀏覽，右上方的分享按鈕更可以將報告分享給他人。



## 睡眠趨勢

當蒐集足夠的睡眠數據後，可以到**趨勢**查看一段時間的改變。



## 設定量測

首先確認穿戴裝置連接狀態。

並將穿戴裝置切換至量測模式。



## 記錄量測

當連接狀態就緒後，點選記錄測量按鈕即可實時量測並記錄至應用程式。



## 填寫問卷

如果您想提供醫生更加確切的睡眠狀況，可至首頁點選填寫問卷。

由於睡眠習慣往往容易根據時間做改變，因此建議每月填寫一次最新資訊。



## 故障排除

## 應用程式無法連接穿戴裝置

- 請根據以下步驟重新嘗試連接：
  1. 完全關閉應用程式（包含背景運作）。
  2. 重新啟動穿戴裝置。
  3. 至藍芽設定找到穿戴裝置名稱並移除。
  4. 按照說明重新進行連接與配對。
- 手動藍芽連接


您可以透過藍芽來手動連接穿戴裝置。

Apple 使用者：

先到設定 > 藍芽中找到名稱為 oCare100\_MBT 的項目，點選進行連接。

Android 使用者：

先到設定 > 連線裝置 > 連線 > 藍芽 > 偏好裝置中找到名稱為 oCare100\_MBT 的項目，點選進行連接。

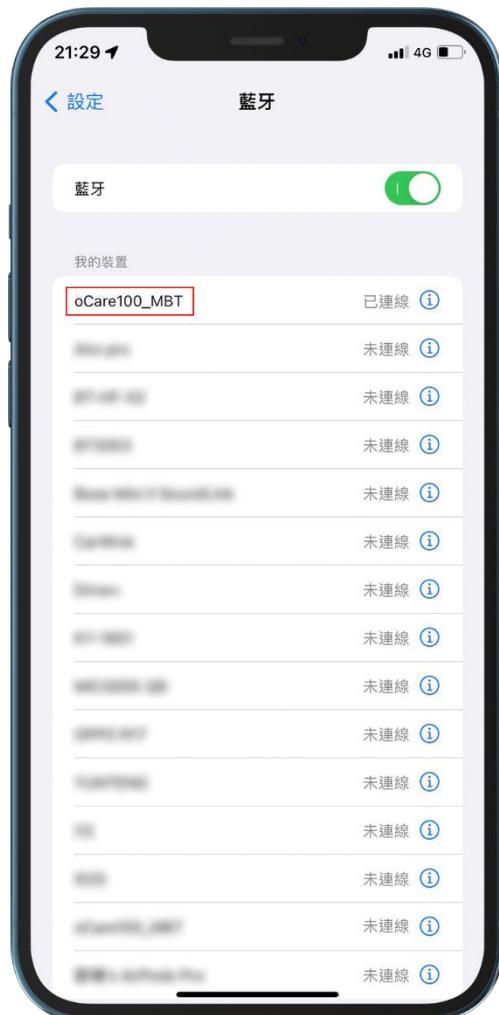

## 同步數據等待時間過長

在一般情況下，6-8 小時的睡眠數據進行上傳，需要等待的時間約為 3-5 分鐘，若您並非每日上傳睡眠數據，將會累積至下次同步時一併上傳，從而導致上傳時間更長，因此建議每日上傳來降低等待時間，而上傳數據後，穿戴裝置內的數據將會自動刪除，以確保容量足夠繼續進行存取。

若應用程式下方白色的上傳狀態停滯過久，請先完全關閉穿戴裝置與應用程式（含背景運作），接著重新啟動應用程式並再次同步。

## 同步後卻沒有數據

- 穿戴裝置並未開啟記錄模式：

請在睡前確認穿戴裝置是否已經開啟記錄模式，若有正確啟動，穿戴裝置右下方將出現攝影機的圖示，您也可以透過應用程式首頁的開始記錄來啟動，此時記錄的數據將會存取在穿戴裝置中，隔日記錄完成再同步數據至應用程式即可。

- 睡眠數據少於 2 小時：

若睡眠時間低於 2 小時，則無法計算出可供參考的 ODI 3% 指數，因無法於應用程式睡眠功能顯示分析報告資料。

## 登入後顯示沒有網路

使用本應用程式需保持網路連線狀態，特別是同步數據與取得睡眠報告，若沒有網路連線將無法從資料庫存取您的數據，因此請保持網路連線後再進行操作，若無網路也可透過 WiFi 進行連線。

## 無法透過應用程式啟動睡眠記錄

請將穿戴裝置重新啟動，並在開機後查看穿戴裝置序號 (ver: X.XXX)，如果您的版本低於 5.202 將無法透過應用程式啟動睡眠記錄，請聯絡客服人員為您更新。